

# Gagless

ディスポ/マウスピース



“奥歯で噛み合わせる”

口腔咽頭の機能に着目した  
ディスポーザブルマウスピース

# Gagless ディスポ/マウスピース


“奥歯で噛み合わせる”

口腔咽喉の機能に着目した  
ディスポーザブルマウスピース




## 従来型

咽喉反射がおこり、  
苦痛が生じる。  
マウスピースが  
脱落することもある。

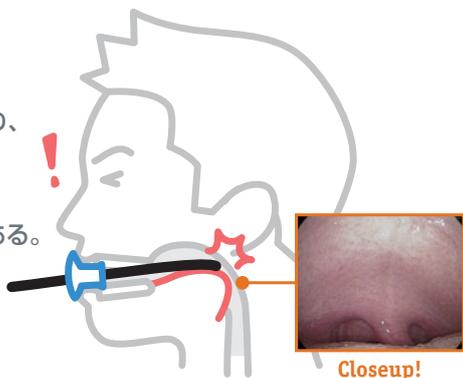


## 新規型

咽喉が広がり、  
スムーズに  
カメラが挿入し、  
咽喉反射が軽減する。

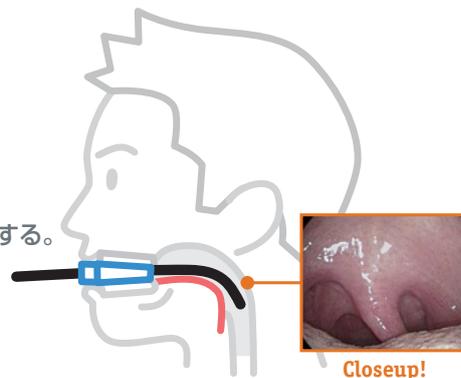


### Step 1

両側から押えながら  
口にくわえます。

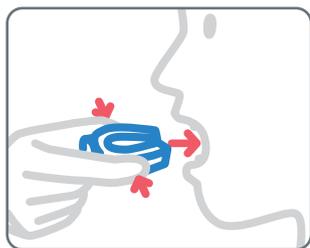

### Step 2


手を離すと  
元の状態にもどります。

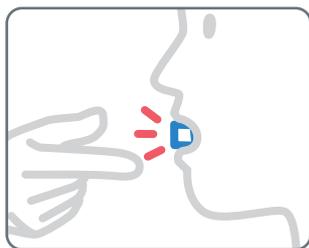

挿入口がふさがらない程度に  
くちびるを閉じてください。

### Step 3


まず奥歯で軽く噛み、  
次に歯全体でゆっくり噛みます。

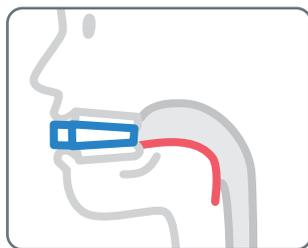

舌を下の前歯に当たるように  
つき出すと、奥舌が下がり、  
のどが広くなります。

### Step 4

内視鏡が  
スムーズに入ります。

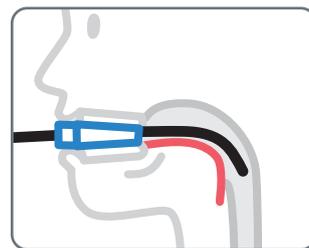

検査中はマウスピースが  
動かない程度に  
軽く噛み続けてください。

## Gagless ディスポ

カタログ番号	製品名	規格	開口部内径	販売単位
M00504050	Gagless ディスポ 50	ディスポーザブル	45F	50個 / 箱入
M00504060	Gagless ディスポ 20	ディスポーザブル	45F	20個 / 箱入

## ブロック内視鏡用バイトブロック



## Gagless マウスピース

カタログ番号	製品名	規格	開口部内径	販売単位
M00504040	Gagless マウスピース	リユース	45F	2個 / 箱入



ノーマルタイプのブロック内視鏡用バイトブロックもラインアップ。詳しくは弊社営業担当へご確認ください。

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：Gagless マウスピース  
製造販売業者：イナバコム株式会社  
製造販売届出番号：31B2X00006000001

販売名：Gagless ディスポ  
製造販売業者：イナバコム株式会社  
製造販売届出番号：31B2X00006000003

販売名：内視鏡用バイトブロック ブロック  
製造販売届出番号：13B1X00043000076

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス  
[www.bostonscientific.jp](http://www.bostonscientific.jp)

2104-35213-A-ODP / PSST20210407-0431